

ADHESIVE RESIN CEMENT SYSTEM

PANAVIA™ 5

SVENSKA] BRUKSANVISNING

I. INTRODUKTION

PANAVIA V5 är ett vidfångande kompositcement-system. PANAVIA V5 består av cementpasta (Paste), Try-in Paste, Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS och K-ETCHANT Syringe. Pastan är ett dubbelhärdande (lys- och/eller självhärdande), fluorid-frigränsat, radiopakt kompositcement för keramik (litum dioksid, zirkonoxid osv.), hybridkeramik (t.ex. ESTENIA C&B), kompositplast och metallrestaureringar. Det levereras i autombländningssystem som blandar lika mängder av två komponenter. Det finns tillgängligt i följande 5 nyanser: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White och Opaque. För den sista härdningen bör nyansen Opaque självhärdas pga sin starka opacitet. Try-in Paste är ett nyansmatchande material med ungefär samma färg och transparens som den härjade blandningen av Paste. Tooth Primer är en självhärtnad för tandstrukturer som påskyndar polymeriseringen av pastan. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS är en dental universell primer som ger en förbättrad vidfångningssyta för keramik, hybridkeramik, kompositplast och metall. K-ETCHANT Syringe är en etsgel som består av 35 % fosforsyra i en vattenbaserad lösning och kollodiat kisel. PANAVIA V5 är färdigbalt och har en rörligspacitet lika med eller större än 1 mm aluminium. I enlighet med ISO4049 klassas matta färger som material i "Klass 1" av typ 2. Övriga färger klassas som material i "Klass 3" av typ 2.

II. INDIKATIONER

PANAVIA V5 används för följande indikationer:

- 1] Cementering av kronor, broar, inlays och onlays
- 2] Cementering av fassader
- 3] Cementering av adhesiva broar och skelett
- 4] Cementering av protetiska restaureringar på implantatstödt och skelett
- 5] Cementering av stift och pelare
- 6] Anlaggn vidhäftning

III. KONTRAIKASJONER

Patienter med tidigare kontakt med metakrylatmonomerer. Patienter med känd allergi mot någon av ingredienserna i denna produkt.

IV. MÖJIGA BIEFFEKTER

- 1] Vid kontakt med produkten kan en vitaktig misfärgning av slemhinnan uppstå p.g.a. proteinkoagulering. Detta är ett tillfälligt fenomen som normalt försvinner inom några få dagar. Uppmana patienten till försiktighet vid den dagliga munhygien.
- 2] K-ETCHANT Syringe kan förorsaka irritation eller erosion om de kemikalier. Var försiktig vid användning av produkten och undvik kontakt med huden eller ögonen.

V. INKOMPATIBILITET

- 1] Använd inga eugenolhaltiga material som skydd för pulpan eller som provisorisk tätning, eftersom eugenol kan orsaka misfärgning och fördröja härdningsprocessen.
- 2] Använd inte blodslidande medel med jämnaltna komponenter, eftersom dessa material kan påverka adhesjonen negativt och orsaka misfärgning (t.ex. maasprocent/ Trietylglykyl diacrylat (TEGDMA)/ Ytbehandlad fyller, aluminiumoxid/ Kollodiat kisel/ Camphorquin/ Initiatorer/Acceleratorer/Pigment
- 3] Använd inte väteperoxidlösning för rengöring av efterbehandling där man förvägar bostyngsfunktion mot tandstrukturen.

VI. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. SÄKERHETSANVISNINGAR
 1. Den här produkten innehåller ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner. Undvik att använda produkten på patienter med känd allergi mot metakrylatmonomerer eller någon av de andra komponenterna.
 2. Om patienten får en överkänslighetsreaktion såsom utslag, exkem, inflammation, sår, svullnader, klåda eller domningar ska behandlingen med produkten avbrytas och en läkare konsulteras.
 3. Undvik direkt kontakt med huden och/ eller munnsens mjuka vävnad för att förebygga överkänsligheter. Använd handskar och vita lämpliga försiktighetsåtgärder när du använder produkten.
 4. Var försiktig vid användning av produkten och undvik kontakt med huden eller ögat. Före användning av produkten ska patientens ögon täckas över med en handduk, eller ska skyddsglasögon användas för att skydda ögonen mot materialslakt.
 5. Om produkten kommer i kontakt med kroppsvätska ska följande åtgärder vidtas:
 - <Om produkten hamnar i ögat>: Skölj omedelbart ögat i rikligt med vatten och kontakta en läkare.
 - <Om produkten kommer i kontakt med huden eller slemhinnans>: Torka omedelbart av med en bomullstuss eller en gasbinda fuktad med alkohol, och skölj därefter med några minuter med vatten.
 - 6. Var försiktig så att patienten inte sväljer produkten.
 - 7. Återanvänd inte blandningspetar, endoppar, kärnspetsar eller appliceringsborstar för att återanvända korskontamination. Denna produkt är avsedd för engångsbruk och ska kastas efter användning.
 - 8. Avfallshantera denna produkt som medicinskt avfall för att undvika smittspridning. Kärnen måste avfallshandteras med övertäckt nålsöppel för att förhindra skada.

2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER vid hantering

[Normala försiktighetsåtgärder]

1. Produkten får inte användas för andra ändamål än de som anges i [II. INDIKATIONER].
2. Denna produkt får endast användas för engångsbruk och ska kastas efter användning.
3. Använd inte produkten som provisoriskt cement. Detta material är avsett för permanent cementering.
4. Använd kofferdier för att förtärliga och förebygga kontaminering.
5. Om nödvändigt gör en pulpspårning i pulpan eller i karnerna med en pulpspårning.
6. Vid användning av temporära material som innehåller tannin eller magnesium ska detta avlägsnas helt för att förhindra misfärgning.
7. När du använder blodslidande medel som innehåller aluminiumoxid, minimera mängden, och undvik kontakt med den häftande ytan. Annars kan bindningsstyrkan mot tandstrukturen förvägas.
8. För att undvika dålig vidhäftning ska ett fyllnadsmaterial, amalgam och provisoriska tätningmaterial avlägsnas helt vid förberedning av kaviteten.
9. Blanda inte produkten med andra dentalmaterial.
10. Om behållaren och/eller instrumentet för denna produkt är skadade ska du skydda dig mot fara och omedelbart upphöra med användningen.
11. Använd inte samma appliceringsborste för både Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.

[Paste]

1. För den sista härdningen bör nyansen Opaque självhärdas pga sitt låga härdningsöpp. Skaven till den protetiska restaureringen kan ljudshärdas.
2. Paste måste användas inom 2 minuter efter det att den har tryckts ut.
3. Polymeriseringen av pastan kommer att påskyndas genom kontakt med Tooth Primer. Processen ska genomföras inom bearbetningsstämle och avlägsna restaureringen. Paste ska appliceras på en fasad åt gången om flera fassader ska cementeras.

Paste härdningstid i munhålan (vid 37 °C efter att ha kommit i kontakt med Tooth Primer)

Arbetstid	60 sekunder
Sättningsid	3 min.

4. Var noga med att undvika onödig exponering för direkt solljus eller härdningsljus. Pastan innehåller en ljushärdningskatalysator som är mycket ljus känslig. Under cementeringen ska vinkeln och/ eller avståndet av polymerisationslampen anpassas för att minska ljusintensiteten som kommer in i kaviteten för att förebygga att pastan polymeriserar i för tid.
5. Använd ingen lentulo-spiral för applicering av pastan i rotkanalen.
6. Om du vill placera pasta i flera rotkanaler på en tand, ska placeringen i en rotkanal avslutas helt innan du fortsätter med nästa. Se till att undvika att överflödigt pasta kan tränga in i en annan rotkanal.
7. Var försiktig vid intraldis dispensering av cementen med mixing tip eller endo tip, för att undvika korskontamination. Tack hela sprutan med ett engångsskydd (t.ex. en plastpåse) för att förhindra saliv- och blodkontaminering. Desinficera sprutan genom att torka av den med absorberande bomull före och efter användning.
8. Överskottscement kan tas bort efter ljushärdning i 3-5 sekunder. När överskott av cement tas bort ska restaureringen hållas på plats så att den inte kan lyftas upp fall det fortfarande finns cement som inte har härdats tillräckligt.

[Try-in Paste]


1. Användningen av Try-in Paste bör begränsas till kontroll av nyansernas färgöverensstämmelse med PANAVIA V5 Paste eller PANAVIA Veneer LC Paste. Try-in Paste bör inte användas för permanent cementering av kronor, broar och fassader. Polymeriseringen av pastan kommer att påskyndas och arbetstiden kommer att vara öfrrilägg.
3. Det kan hända att det finns transparent vätska i spetsen av Try-in Paste sprutan. Om denna vätska finns bör den avlägsnas och kastas, eftersom den kan påverka nyansanpassningen.
4. Värdering av nyanserna med Try-in Paste ska utföras med ungefär samma tjocklek av Try-in Paste som den härjade cementen.
5. Efter användning, tvätta av Try-in Paste från restaureringen och tandytan med vatten för att undvika dålig vidhäftning.

[Tooth Primer]

1. Används inom 5 minuter efter dispensering.
2. Används inte för yttbehandling av implantatfasiten, pelare och protetiska restaureringar (inlays, onlays, kronor, broar och fassader). Polymeriseringen av pastan kommer att påskyndas och arbetstiden kommer att vara öfrrilägg.
3. Används endast med PANAVIA V5 Paste eller PANAVIA Veneer LC Paste. **Används inte tillsammans med andra kompositcement** (t.ex. PANAVIA F 2.0).
4. Rengör kaviteten noggrant för att undvika dålig adhesion. Om bondningsytan är kontaminerad med saliv eller blod, ska den rengöras ordentligt och torkas. Applicera sedan Tooth Primer igen.

[CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS]

1. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS bör användas så fort som möjligt efter det att den har tryckts ut. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS innehåller flyktig etanol. När lösningsmedlet avdunstar ökar viskositeten, detta kan göra medlet svårapplicerbart.
2. Genomför bindningen (eller cementeringen) snart efter det att restaurationsytan yta har behandlats med CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS.
3. Om den behandlade ytan är kontaminerad med saliv eller blod, ska den tvättas av med vatten, torkas, rengöras med K-ETCHANT Syringe och sedan behandlas igen.

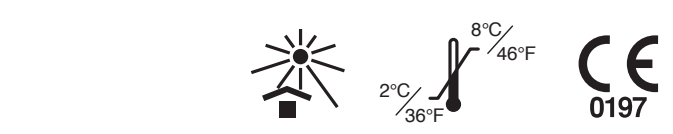

[K-ETCHANT Syringe]

1. Var noga med att inte blanda den med saliv eller blod. Om den behandlade ytan är förorenad måste den behandlas igen.
2. Var noga med att förhindra korskontaminering. Desinficera sprutan före och efter användning med en bomullstuss och ett inderkätt alkoholt. Tack över hela sprutan med ett engångsskydd för att förhindra kontaminering med saliv eller blod.
3. Om produkten hamnar på kläder, ska dessa sköljas med vatten.
4. Efter varje användning ska kärnen avlägsnas från sprutan och omedelbart förslutats tätt med locket.
5. Etsning av vitat dentin kan ge postoperativt känslighet.

[Hårdjulsampa]

1. Används enligt hårdjulsampans bruksanvisning.
2. Titta inte direkt in i ljuskällan. Vi rekommenderar skyddsglasögon.
3. Låg ljusstyrka förorsakar en dålig adhesion. Kontrollera lampans livslängd och hårdjulsampans LUSLEDARSPETS. Vi rekommenderar att mixa mellanrum kontrollera hårdjulsampans ljusstyrka.
4. Ljusledarspetsen i hårdjulsampnan måste hållas vertikalt mot och så nära kompositens yta som möjligt. Om en stor yta ska härjas, rekommenderar vi att ytan delas in i flera områden som ljudhärdas var för sig.
5. Kontrollera vilka villkor som gäller för att härja pastan genom att kontrollera ljushärdningsstiden i denna bruksanvisning innan du använder produkten.

3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRVARING

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

VI. KOMponenter

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer och CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS måste förvaras (2-8 °C/36-46 °F) när de inte används, och bör anpassas till rumstemperatur i 15 minuter före användning, för att återställa deras normala viskositet och härdningsegenskaper. Try-in Paste och K-ETCHANT Syringe bör förvaras vid 2-25 °C/36-77 °F när de inte används.
3. Produkten får inte utsläpas för uttöm hett, direkt solbestrålning eller öppen eld.
4. Locket ska sättas tillbaka på flaskan eller sprutan omedelbart efter det att resnet har dispenserats från flaskan eller sprutan. På så sätt undviks lösningsmedlet kan avdunsta.
5. Produkten måste förvaras på säkert plats, där den endast är tillgänglig för tandvårdspersonalen.

1. Produkten måste användas innan förfalldatumet som står på förpackningen.
2. Paste, Tooth Primer

A-6. Klargjöring av sprøyten og tilbehøret

(1) Sett en blandespiss eller Endo-tip på PANAVIA V5 Paste-sprøyten på vanlig måte.

[FORSIKTIG]

Blandespissen eller Endo-tip settes på, må du trykke ut en liten mengde av begge pastene. Kontroller at det kommer like store mengder ut av begge åprिंगene eller Endo-tipen. Kast denne pastamengden. Bruk ulike mengder pasta, er det fare for dårlig herding.

[MERKNAD]

- Etter bruk sprøyten oppbevares med hatten på. Når du setter hatten på sprøyten igjen for lagring, må du påse at det ikke er pasta på hatten.
- Når en gammel blandespiss eller Endo tip skiftes ut med en ny spiss eller tip, virr du blandespissen i 14-16 sekunder med klokken, slik at sporene på blandespissen eller Endo-tipen står ved rillene på sprøyten. Ta av spissen ved å presse den nedover og vri den av sprøyten.
- Når pasten er herdet, kan pastablandingen ikke lenger enkelt trykkes ut av sprøyten. Bruk et egnet instrument til å fjerne herdet pasta.
- Når du endrer retningen til en Endo tip, må du påse at du virr distalenden, og ikke bryer den tykke dispenserdelen til Endo tip-en.

A-7. Sementering av den protetiske restaureringen

(1) Påfør pastablandingen på hele den protetiske restaureringens heftende flate eller på hele distansen i kavitetten. Has pasten introarat direkte inn i hele kavitetvandsensen, må du begynne med punkt (2) innen 60 sekunder etter at pasten er påført.

(2) Sett den protetiske restaureringen inn i kaviteten eller på distansen.

A-8. Fjerne overskytende sement og påfølgende herding

A-8-a. For fargene Universal (A2), Clear, Brown (A4) eller White:

(1) Fjern overflødig sement på en av de to følgende måtene:
Metode for å fjerne kort herdet overskytende sement:
Lysherde overskytende sement i 3 til 5 sekunder på flere steder. Hold restaureringen på plass på et egnet sted og fjern smert-herdet overskytende sement med en dentalsonde. Det anbefales å kontrollere hvor lenge den påfølgende sementen skal lysherdes ved å lysherde en liten pastamengde på en blandespiss på forhånd.

Metode for fjerning med liten børste:

Overskytende sement på kantene kan fjernes med en liten børste. Lysherde kantene på den protetiske restaureringen med et av de følgende tabellene. Se herdediene i tabell 1.
(For fjerning av kantene på en restaurering kan disse tildekkene med en beskyttende gel (f.eks. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) som beskytter bruksinformasjonen, for å unngå at det dannes et oksygenhittingslag.)

(2) Til slutt herdes sementen på en av de to følgende måtene:
Protetiske restaureringer som ikke er translucente (f.eks. metallkroner):
La sementen herdes kjemisk ved å la den hvile i 3 minutter etter at den protetiske restaureringen er på plass.

Protetiske restaureringer som er translucente (f.eks. keramikk innlegg):
Lysherde hele overflaten på den protetiske restaureringen med herdelampen. Hvis områdene som skal lysherdes er større enn lysutgangen, må belysningsprosessen deles inn i flere trinn.

Se følgende tabell for herdetid:

C-8. Forberedelse for sluttrestaurering

For kjerner:
La kjernen feste seg i 6 minutter og forsikre deg om at sementen er helt herdet for du forbereder oppbyggingsstangen (abutment).

Lyskyltetype (lysinstranstet)	Herdetid
BLUE LED* høy lysintensitet (mer enn 1500 mW/cm²)	To ganger 3 eller 5 sekunder
BLUE LED * (800-1400 mW/cm²)	10 sek.
Halogenlampe (mer enn 400 mW/cm²)	10 sek.

Effektivt beløpsegndenshet for hver dentalherdedenhet må ligge på 400-515 mm.
* Toppen av utslippsposen: 450 - 480 nm

Arbeids- og herdediene er avhengige av temperaturen i omgivelsene og munnen iht. opplysningene nedenfor. Er rumntemperaturen ikke ytterligere spesifisert i denne bruksanvisningen, fastsettes den til 37 °C/99 °F. Vær også oppmerksom på at denne sementen er dobbeltberedende og derfor eliminerer overfor døyslys og kunstlig lys.

Tabell 2: Bearbeidings- og herdetider (for sementering av kroner, broer, innlegg, onlays, laminater og adhesjonsbroer)

Bearbeidingsstid etter første applisering (23°C/ 73°F)	2 min.
Bearbeidingsstid etter at pasten er hatt i kaviteten (37°C/ 99°F)	60 sek.

Kort herding (ack-curing) for fjerning av overskytende sement

Påfølgende herding etter at restaureringen er satt inn	
lysherding (LED)	10 sek. *
selvherding (37°C/ 99°F)	3 min.

* Herdetid ved bruk av den BLÅ LED-en (lysinstranstet: 800-1400 mW/cm²)

A-8-b. For fargen Opague:

(1) Overskytende sement på kantene kan fjernes med en liten børste. Lysherde kantene på den protetiske restaureringen med herdelampen. Se herdediene i tabell 1.
For herding av kantene på en restaurering kan disse tildekkene med en beskyttende gel (f.eks. PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II) som beskytter bruksinformasjonen, for å unngå at det dannes et oksygenhittingslag.)
(2) La sementen herdes kjemisk ved å la den hvile i 3 minutter etter at den protetiske restaureringen er på plass.

B. Standardprosedyre II (Indikasjonjer [4])

[4] Sementering av restaureringen på implantat-distanser og skjeletter

B-1. Rengjøre implantat-distansen eller skjelettet, prøve og tilpasse en restaurering, kondisjonere overflaten på den protetiske restaureringen

Se avsnitt «A-1», «A-2» og «A-3».

B-2. Applisering av CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS

Påfør CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS med en applikatorbørste på restaureringens innvendige flate og de heftende flatene til implantat-distansene eller skjelettene. Etter appliseringen, tørk hele adhesjonsflaten grundig med mild olefri luffen.

[MERKNAD]

Optimale resulatater oppnås ved bruk av ALLOY PRIMER i stedet for CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på edelmetallleggerens overflate. Nærmere detaljer finnes i bruksinformasjonen for ALLOY PRIMER.

B-3. Klargjöring av sprøyten og tilbehøret

Se avsnitt «A-6».

B-4. Sementering av den protetiske restaureringen

(1) Påfør pastablandingen på hele den heftende flaten til den protetiske restaureringen. (2) Sett den protetiske restaureringen på implantat-distansen eller skjelettet.

B-5. Fjerne overskytende sement og påfølgende herding

B-5-a. For fargene Universal (A2), Clear, Brown (A4) eller White:

(1) Fjern overskytende sement. Se avsnitt «A-8-a (1)».

(2) Til slutt herdes sementen på en av de to følgende måtene:
Protetiske restaureringer som ikke er translucente (f.eks. metallkroner):
La sementen herdes kjemisk etter at den protetiske restaureringen er satt inn. Se tabell 3.

Protetiske restaureringer som er translucente (f.eks. keramikk innlegg):
Lysherde hele overflaten på den protetiske restaureringen med herdelampen. Hvis områdene som skal lysherdes er større enn lysutgangen, må belysningsprosessen deles inn i flere trinn.

Se herdediene i tabell 1.

B-5-b. For fargen Opague:

(1) Behandle overskytende sement. Se avsnitt «A-8-b (1)».

(2) La sementen herdes kjemisk etter at den protetiske restaureringen er satt inn. Se tabell 3.

C. Standardprosedyre III (Indikasjonjer [5])

[5] Sementering av stifter og kjerner

C-1. Klargjöring av kavitert og prøving av kjerne eller stift

(1) Forbered de endokort og/eller forbered for plassering av stift/ kjerne på vanlig måte. Sørg for fuktighetskontroll og bruk kofferdim.

(2) Prøv enn kjerne eller roststift (f.eks. PANAVIA POST) i passende tykkelse i den klargjorte kavitetten. Dimensjoner og tilpas stiftten. Tork bort urenheter fra overflaten til kjernen eller stiftten ved hjelp av en vattpott eller gasbind som er dyppet i alkohol.

C-2. Sandblåsing av (den individuelle) kjernepoppbyggingen eller roststiften

Sandblåsing overflaten på distansen eller stiften som beskrevet i trinn «A-3». Ikke sandblås glassblåsingstoffer, da dette kan føre til skader.

C-3. Behandle distansen eller stiften

For metallisk kjerne og metallisk stift:
Påfør CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på distanse- eller stiftoverflaten ved bruk av en applikatorbørste. Etter appliseringen, tørk hele adhesjonsflaten grundig med mild olefri luffen.

[MERKNAD]

Optimale resulatater oppnås ved bruk av ALLOY PRIMER i stedet for CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på edelmetallleggerens overflate. Nærmere detaljer finnes i bruksinformasjonen for ALLOY PRIMER.

For komposittkjerner, glassbørstestift og keramiskstift:

(1) Påfør K-ETCHANT Syringe på distanse- eller stiftoverflaten. Ha den på plass for 5 sekunder for rensing og tørring.

(2) Påfør CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS på distanse- eller stiftoverflaten ved bruk av en applikatorbørste. Etter appliseringen, tørk hele adhesjonsflaten grundig med mild olefri luffen.

C-4. Applisering av Tooth Primer

(1) Appliser Tooth Primer i rotkanalen og på kavitettsveggen ved hjelp av en applikatorbørste, og la det virke i 20 sekunder. Påse at behandlingsoverflaten ikke kommer i berøring med syttel eller eksudat.

(2) Bruk en papirspiss til å fjerne overskytende Tooth Primer-væske forsiktig fra rotkanalen eller kavitetten (fremfor alt fra kavitettkantene og inne i rotkanalen).

(3) Tork hele den protetiske restaureringen til tilstrekkelig og grundig med en lett, olefri luftstrøm. Bruk et sugetrøkk for å forhindre at Tooth Primer-væsken renner utover.

C-5. Klargjöring av sprøyten og tilbehøret

Se avsnitt «A-6».

C-6. Plassering av kjernen eller stiften

(1) Påfør pastablandingen på hele den heftende flaten til kjernen eller stiften, eller på hele kavitetsoverflaten. Has pasten direkte inn i kaviteten, må du begynne med punkt (2) innen 60 sekunder etter at sementen er påført.

(2) Sett kjernepoppbyggingen eller roststiften raskt inn i kaviteten og skyv den forsiktig fram og tilbake for å unngå luftbobler i rotkanalen.

C-7. Behandle den overskytende sementen

For kjerner:
Se avsnitt «A-8-a (1)» eller «A-8-b (1)».

For stifter:

Bruk en applikatorbørste og fordel overskytende sement over den resterende kronen og stifttoden.

C-8. Herding

Lysherd tannhalsene til kjernen eller stiften. Se tabell 1 i «A-8».

La sementen med farge Opague herdes kjemisk i 3 minutter ved å la den hardne etter at distansen eller stiften er satt inn.

C-9. Forberedelse for sluttrestaurering

For kjerner:
La kjernen feste seg i 6 minutter og forsikre deg om at sementen er helt herdet for du forbereder oppbyggingsstangen (abutment).

D. Standardprosedyre IV (Indikasjonjer [6])

[6] Amalgambinding

D-1. Rengjøre tannsubstansen

Rengjør kaviteten og tork den på vanlig måte.

D-2. Påføre Tooth Primer, forberede sprøyte og tilbehør

(1) Påfør sementblandingen på hele overflaten i kaviteten. Begynn med punkt (2) innen 60 sekunder etter at sementen er påført.

(2) Det pulveriserete amalgamet bør presses sammen på den ikke-stivende pastablandingen. Okkulsal tilskjering på vanlig måte.

D-3. Plassere amalgamet

(1) Påfør sementblandingen på hele overflaten i kaviteten. Begynn med punkt (2) innen 60 sekunder etter at sementen er påført.

(2) Det pulveriserete amalgamet bør presses sammen på den ikke-stivende pastablandingen. Okkulsal tilskjering på vanlig måte.

D-4. Fjerne overskytende sement og påfølgende herding

Se avsnitt «A-8».

[GARANT]

Kuraray Noritake Dental Inc. vil erstatte alle produkter som er bevist defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. godtar ikke ansvar for tap eller skade, direkte, av konsekvens eller spesiell, som oppstår ved påføring eller bruk av eller manglende evne til å bruke disse produktene. For bruk skal brukeren avløre egenheten til produktene for tiltenkt bruk og brukeren påtar seg all risiko og ansvar i henhold til dette.

[MERKNAD]

Avslørige hendelser som kan tilordnes produktet, skal meldes til produsentens nedenfor angitte autoriserte representant og tilsynmyndighetene i landet der brukeren/pasienten bor.

[MERKNAD]

"PANAVIA" og "CLEARFIL" og "ESTENIA"er varemerker av KURARAY CO., LTD.

"KATANNA" er et varemerke av NORITAKE CO., LIMITED.

SUOMI | KÄYTTÖOHJEET

I. JOHDANTO

PANAVIA V5 adhesiivien resinisementijärjestelmä, PANAVIA V5 -järjestelmään kuuluvat sementtipasta (Paste), Tooth Primer, CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS ja K-ETCHANT Syringe. Pasta on kaksoisovetteinen (valo- ja/tai kemiallisovetteinen), fluoridit vapauttava, radioopakekti resini sementti keramiisille (liitumadilikaatti, zirkoniumoksidi jne.), hybridiseramille (esim. ESTENIA C&B), yhdistelmämuovisille ja metallisille restauroitille. Se toimineaan automaattisesti lokoitavassa toimijärjestelmässä, joka sekoittaa toisinsa yhtä suuret määrät kahta eri komponenttia. Siitä on saatavana seuraavat 5 väriä: Universal (A2), Clear, Brown (A4), White ja Opague. Opague-väriin tulisi antaa kovettua kemiallisesti sen vuoksi, että K-ETCHANT Syringe on värinpoistavain, joka värj ja liikkuvuutta vastaavat joksenkkin komponentin Paste-seoksen ominaisuuksilla. Tooth Primer on itse-estautuva hammersakenteinen putouspasta, joka nopeuttaa pastan polymerisointia. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS on hartsiläpikäsitellyiseen käyttöön tarkoitettu restauroitiden yleisprimeri, joka parantaa keramiin, hybridiseramiin, yhdistelmämuovin ja metallien tartuntapinta. K-ETCHANT Syringe on etsausgeeli, joka kostuu fosforihapon 35 % vesiliuoksesta ja kolloidista piistä. PANAVIA V5 -värimaine sävy säilyt stabilina, sen röngensopittuvissa vastaa yli 1 mm n alumiiniväruutta. Standardin ISO4049 mukaan opakesti säilyt kuitollaan tyyppi 2 "luokan 1" materiaaleiksi ja muut sävyt tyyppi 2 "luokan 3" materiaaleiksi.

II. KÄYTTÖTARKOITUKSET

PANAVIA V5 soveltuu käytettäväksi seuraavissa tapauksissa:
[1] Keramiisten kruunujen, siltojen, inlay- ja onlay-täytteiden sementointi
[2] Laminattien sementointi
[3] Adhesiivien siltojen ja spinttien sementointi
[4] Proteesirestauroitiden lopullinen sementointi implantaabuttmentteihin
[5] Nastojen ja plareiden sementointi
[6] Amalgamin sidostaminen

III. KONTRAINDIKAATIO

Potilaita, joilla on aiemmin esiintynyt yliherkyyttä metakrylaattionnomenierin suhteen. Potilaita, joiden tiedetään olevan allergisia jollakin tämän tuotteen ainesosalle.
[1] Suun limakalvoilla tuotteen kanssa kosketuksiin joutumisen jälkeen muuttua proteiinin koagulaation johdosta vaaaleaksi. Kyseessä on tilapäinen ilmiö, joka katoaa tavallisesti muutamnan päivän sisällä. Potilasta on opastettava välttämään käsittelyn alueen ärsyttämistä herjauksen aikana.
[2] K-ETCHANT Syringe voi aiheuttaa ärsytystä kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi. Tuotteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, ettei sitä joudu iholle tai silmiin.

IV. MAHDOLLISET SIVUVAIKUTUKSET

[1] Suun limakalvoilla tuotteen kanssa kosketuksiin joutumisen jälkeen muuttua proteiinin koagulaation johdosta vaaaleaksi. Kyseessä on tilapäinen ilmiö, joka katoaa tavallisesti muutamnan päivän sisällä. Potilasta on opastettava välttämään käsittelyn alueen ärsyttämistä herjauksen aikana.
[2] K-ETCHANT Syringe voi aiheuttaa ärsytystä kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi. Tuotteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, ettei sitä joudu iholle tai silmiin.

V. YHTEENSOPIVUUS

[1] Suun limakalvoilla tuotteen kanssa kosketuksiin joutumisen jälkeen muuttua proteiinin koagulaation johdosta vaaaleaksi. Kyseessä on tilapäinen ilmiö, joka katoaa tavallisesti muutamnan päivän sisällä. Potilasta on opastettava välttämään käsittelyn alueen ärsyttämistä herjauksen aikana.
[2] K-ETCHANT Syringe voi aiheuttaa ärsytystä kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi. Tuotteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, ettei sitä joudu iholle tai silmiin.

VI. TURVATOIMENPITEET

[1] Tämä tuote sisältää aineita, jotka saattavat aiheuttaa allergisen reaktion. Älä käytä tuotetta potilaita, jotka ovat allergisia metakrylaattionnomeniereille tai muille ainesosille.
[2] Jos potilaasta syntyy yliherkyyttä, esimerkiksi ihotulehdus, tulehdus, oireet, hajuvaunut, turvotus, kurtina tai turmottumus, lopetettakaa tuotteen käyttö ja käännyttää lääkärin puoleen.
[3] Välttääkää suoraan kosketusta ihon ja/tai pehmytkudoksiin, se saattaa aiheuttaa yliherkyyttä. Käyttäkää tuotteen käyttämisen aikana suojakäsineitä ja käyttekää muita varoimenpiteitä.
[4] Tuotteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, ettei sitä joudu iholle tai silmiin. Ennen tuotteen käyttöä potilaita on sijoitettava mahdollisilta roiskeilta peteilimellä tai suojalasella.
[5] Jos tuotetta joutuu kosketuksiin ihmisen kudoksiin kanssa, toimi seuraavasti:
- Huuhteile silmiä välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkärin.
- Jos tuotetta päässään iholle tai suun limakalvoille > Pyyhi välittömästi pois alkoholilla kostutettulla vanupurolla tai harsotatkuksella ja huuhteile runsaalla vedellä.
[6] Ole varovainen, ettei potilas vähingoissa niele tuotetta.
[7] Älä käytä sekotuskärkeä, endo-kärkeä, neulakärkeä ja levityssiveliä uudelleen ristikonaminaation estämiseksi. Ne ovat kertakäyttöisiä ja ne on hävitettävä käytön jälkeen.
[8] Enkaise infektiolta hävittämällä tämä tuote lääketieteellisenä jätteenä. Vältä vammoja hävittämällä neulat vain kätjet suojattuina.

VI. TURVATOIMENPITEET

[1] Tämä tuote sisältää aineita, jotka saattavat aiheuttaa allergisen reaktion. Älä käytä tuotetta potilaita, jotka ovat allergisia metakrylaattionnomeniereille tai muille ainesosille.
[2] Jos potilaasta syntyy yliherkyyttä, esimerkiksi ihotulehdus, tulehdus, oireet, hajuvaunut, turvotus, kurtina tai turmottumus, lopetettakaa tuotteen käyttö ja käännyttää lääkärin puoleen.
[3] Välttääkää suoraan kosketusta ihon ja/tai pehmytkudoksiin, se saattaa aiheuttaa yliherkyyttä. Käyttäkää tuotteen käyttämisen aikana suojakäsineitä ja käyttekää muita varoimenpiteitä.
[4] Tuotteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, ettei sitä joudu iholle tai silmiin. Ennen tuotteen käyttöä potilaita on sijoitettava mahdollisilta roiskeilta peteilimellä tai suojalasella.
[5] Jos tuotetta joutuu kosketuksiin ihmisen kudoksiin kanssa, toimi seuraavasti:
- Huuhteile silmiä välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkärin.
- Jos tuotetta päässään iholle tai suun limakalvoille > Pyyhi välittömästi pois alkoholilla kostutettulla vanupurolla tai harsotatkuksella ja huuhteile runsaalla vedellä.
[6] Ole varovainen, ettei potilas vähingoissa niele tuotetta.
[7] Älä käytä sekotuskärkeä, endo-kärkeä, neulakärkeä ja levityssiveliä uudelleen ristikonaminaation estämiseksi. Ne ovat kertakäyttöisiä ja ne on hävitettävä käytön jälkeen.
[8] Enkaise infektiolta hävittämällä tämä tuote lääketieteellisenä jätteenä. Vältä vammoja hävittämällä neulat vain kätjet suojattuina.

VI. TURVATOIMENPITEET

[1] Tämä tuote sisältää aineita, jotka saattavat aiheuttaa allergisen reaktion. Älä käytä tuotetta potilaita, jotka ovat allergisia metakrylaattionnomeniereille tai muille ainesosille.
[2] Jos potilaasta syntyy yliherkyyttä, esimerkiksi ihotulehdus, tulehdus, oireet, hajuvaunut, turvotus, kurtina tai turmottumus, lopetettakaa tuotteen käyttö ja käännyttää lääkärin puoleen.
[3] Välttääkää suoraan kosketusta ihon ja/tai pehmytkudoksiin, se saattaa aiheuttaa yliherkyyttä. Käyttäkää tuotteen käyttämisen aikana suojakäsineitä ja käyttekää muita varoimenpiteitä.
[4] Tuotteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, ettei sitä joudu iholle tai silmiin. Ennen tuotteen käyttöä potilaita on sijoitettava mahdollisilta roiskeilta peteilimellä tai suojalasella.
[5] Jos tuotetta joutuu kosketuksiin ihmisen kudoksiin kanssa, toimi seuraavasti:
- Huuhteile silmiä välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkärin.
- Jos tuotetta päässään iholle tai suun limakalvoille > Pyyhi välittömästi pois alkoholilla kostutettulla vanupurolla tai harsotatkuksella ja huuhteile runsaalla vedellä.
[6] Ole varovainen, ettei potilas vähingoissa niele tuotetta.
[7] Älä käytä sekotuskärkeä, endo-kärkeä, neulakärkeä ja levityssiveliä uudelleen ristikonaminaation estämiseksi. Ne ovat kertakäyttöisiä ja ne on hävitettävä käytön jälkeen.
[8] Enkaise infektiolta hävittämällä tämä tuote lääketieteellisenä jätteenä. Vältä vammoja hävittämällä neulat vain kätjet suojattuina.

VI. TURVATOIMENPITEET

[1] Tämä tuote sisältää aineita, jotka saattavat aiheuttaa allergisen reaktion. Älä käytä tuotetta potilaita, jotka ovat allergisia metakrylaattionnomeniereille tai muille ainesosille.
[2] Jos potilaasta syntyy yliherkyyttä, esimerkiksi ihotulehdus, tulehdus, oireet, hajuvaunut, turvotus, kurtina tai turmottumus, lopetettakaa tuotteen käyttö ja käännyttää lääkärin puoleen.
[3] Välttääkää suoraan kosketusta ihon ja/tai pehmytkudoksiin, se saattaa aiheuttaa yliherkyyttä. Käyttäkää tuotteen käyttämisen aikana suojakäsineitä ja käyttekää muita varoimenpiteitä.
[4] Tuotteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, ettei sitä joudu iholle tai silmiin. Ennen tuotteen käyttöä potilaita on sijoitettava mahdollisilta roiskeilta peteilimellä tai suojalasella.
[5] Jos tuotetta joutuu kosketuksiin ihmisen kudoksiin kanssa, toimi seuraavasti:
- Huuhteile silmiä välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkärin.
- Jos tuotetta päässään iholle tai suun limakalvoille > Pyyhi välittömästi pois alkoholilla kostutettulla vanupurolla tai harsotatkuksella ja huuhteile runsaalla vedellä.
[6] Ole varovainen, ettei potilas vähingoissa niele tuotetta.
[7] Älä käytä sekotuskärkeä, endo-kärkeä, neulakärkeä ja levityssiveliä uudelleen ristikonaminaation estämiseksi. Ne ovat kertakäyttöisiä ja ne on hävitettävä käytön jälkeen.
[8] Enkaise infektiolta hävittämällä tämä tuote lääketieteellisenä jätteenä. Vältä vammoja hävittämällä neulat vain kätjet suojattuina.

VI. TURVATOIMENPITEET

[1] Tämä tuote sisältää aineita, jotka saattavat aiheuttaa allergisen reaktion. Älä käytä tuotetta potilaita, jotka ovat allergisia metakrylaattionnomeniereille tai muille ainesosille.
[2] Jos potilaasta syntyy yliherkyyttä, esimerkiksi ihotulehdus, tulehdus, oireet, hajuvaunut, turvotus, kurtina tai turmottumus, lopetettakaa tuotteen käyttö ja käännyttää lääkärin puoleen.
[3] Välttääkää suoraan kosketusta ihon ja/tai pehmytkudoksiin, se saattaa aiheuttaa yliherkyyttä. Käyttäkää tuotteen käyttämisen aikana suojakäsineitä ja käyttekää muita varoimenpiteitä.
[4] Tuotteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, ettei sitä joudu iholle tai silmiin. Ennen tuotteen käyttöä potilaita on sijoitettava mahdollisilta roiskeilta peteilimellä tai suojalasella.
[5] Jos tuotetta joutuu kosketuksiin ihmisen kudoksiin kanssa, toimi seuraavasti:
- Huuhteile silmiä välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkärin.
- Jos tuotetta päässään iholle tai suun limakalvoille > Pyyhi välittömästi pois alkoholilla kostutettulla vanupurolla tai harsotatkuksella ja huuhteile runsaalla vedellä.
[6] Ole varovainen, ettei potilas vähingoissa niele tuotetta.
[7] Älä käytä sekotuskärkeä, endo-kärkeä, neulakärkeä ja levityssiveliä uudelleen ristikonaminaation estämiseksi. Ne ovat kertakäyttöisiä ja ne on hävitettävä käytön jälkeen.
[8] Enkaise infektiolta hävittämällä tämä tuote lääketieteellisenä jätteenä. Vältä vammoja hävittämällä neulat vain kätjet suojattuina.

VI. TURVATOIMENPITEET

[1] Tämä tuote sisältää aineita, jotka saattavat aiheuttaa allergisen reaktion. Älä käytä tuotetta potilaita, jotka ovat allergisia metakrylaattionnomeniereille tai muille ainesosille.
[2] Jos potilaasta syntyy yliherkyyttä, esimerkiksi ihotulehdus, tulehdus, oireet, hajuvaunut, turvotus, kurtina tai turmottumus, lopetettakaa tuotteen käyttö ja käännyttää lääkärin puoleen.
[3] Välttääkää suoraan kosketusta ihon ja/tai pehmytkudoksiin, se saattaa aiheuttaa yliherkyyttä. Käyttäkää tuotteen käyttämisen aikana suojakäsineitä ja käyttekää muita varoimenpiteitä.
[4] Tuotteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, ettei sitä joudu iholle tai silmiin. Ennen tuotteen käyttöä potilaita on sijoitettava mahdollisilta roiskeilta peteilimellä tai suojalasella.
[5] Jos tuotetta joutuu kosketuksiin ihmisen kudoksiin kanssa, toimi seuraavasti:
- Huuhteile silmiä välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkärin.
- Jos tuotetta päässään iholle tai suun limakalvoille > Pyyhi välittömästi pois alkoholilla kostutettulla vanupurolla tai harsotatkuksella ja huuhteile runsaalla vedellä.
[6] Ole varovainen, ettei potilas vähingoissa niele tuotetta.
[7] Älä käytä sekotuskärkeä, endo-kärkeä, neulakärkeä ja levityssiveliä uudelleen ristikonaminaation estämiseksi. Ne ovat kertakäyttöisiä ja ne on hävitettävä käytön jälkeen.
[8] Enkaise infektiolta hävittämällä tämä tuote lääketieteellisenä jätteenä. Vältä vammoja hävittämällä neulat vain kätjet suojattuina.

VI. TURVATOIMENPITEET

[1] Tämä tuote sisältää aineita, jotka